1. Funkcja trybu Lattice (siatkowego):

(1) Leczenie skóry o wyglądzie truskawkowym
(2) Usuwanie głębokich zmarszczek i przebarwień na ustach
(3) Usuwanie rozstępów
(4) Lifting górnych powiek (klient musi mieć założone osłony na gałki oczne)
(5) Usuwanie blizn
(6) Usuwanie przebarwień skóry twarzy i ciała
(7) Resurfacing (odmładzanie) skóry
(8) Usuwanie zmarszczek
(9) Ujędrnianie skóry

Parametry zabiegu:

- Moc: 3–7 W, regulowana
- Czas trwania: 0,6 ms
- Czas przerwy: 1,0 ms
- Odstęp między punktami: 0,6 mm
- Tryb skanowania: losowy
- Liczba skanów: 1







---


2. Funkcja trybu impulsowego:


(1) Usuwanie włókniaków skóry
(2) Usuwanie pieprzyków
(3) Cięcia medyczne
(4) Usuwanie brodawek

Parametry zabiegu:

- Moc: 1 W
- Tryb: pojedynczy
- Czas pozostania punktu: 1 ms
- Szerokość impulsu: 0,3 ms
- Przerwa: 2,0 ms



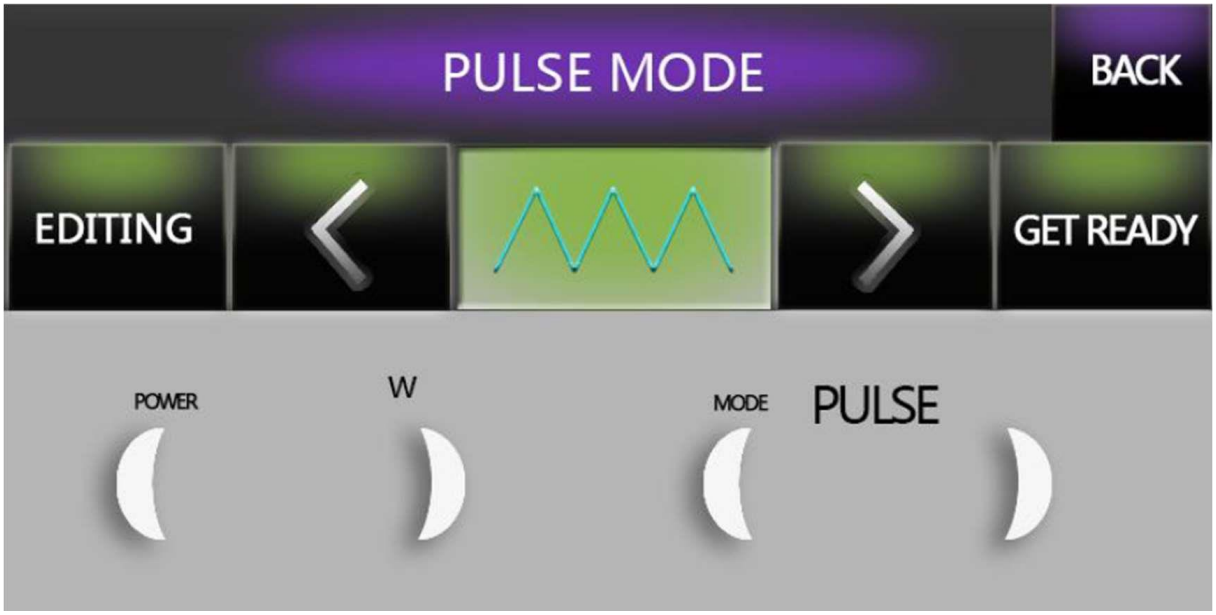


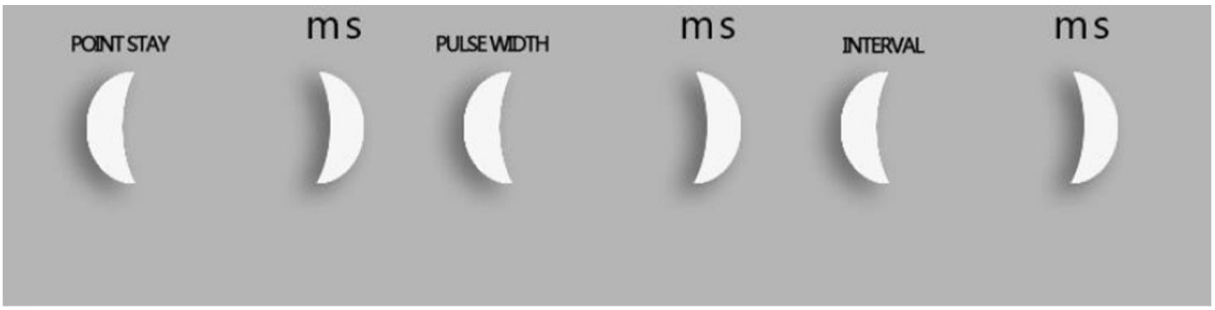




Tryby pracy:


- **Tryb pojedynczy:** Po naciśnięciu pedału urządzenie działa tylko raz. Dokładna kontrola czasu pracy, używana do usuwania zmian skórnych.

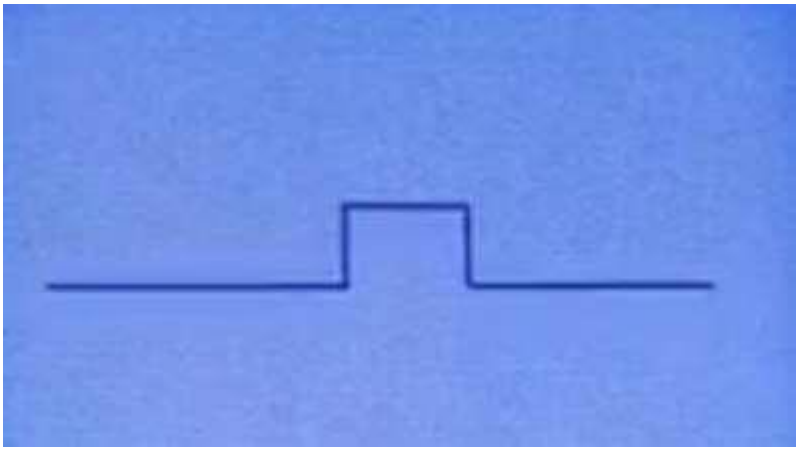

- **Tryb ciągły:** Urządzenie działa w sposób ciągły, dostarczając tę samą energię w każdym obszarze zabiegowym. Zazwyczaj nie stosuje się tego trybu w zabiegach kosmetycznych (podczas trybu ciągłego tkanka skórna jest stopniowo osuszana, a temperatura może osiągnąć 600 ℃, należy zachować ostrożność). Używany głównie do cięć medycznych i napromieniowań.

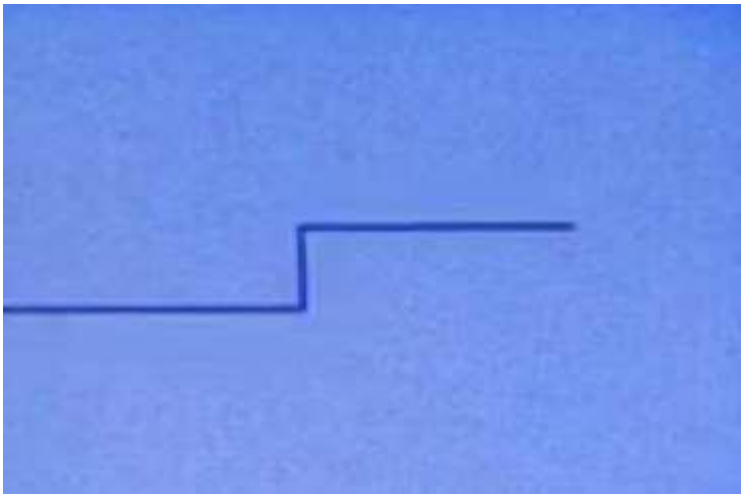

- **Tryb impulsowy:** Super impuls. Im mniejsza częstotliwość, tym dłuższy czas między impulsami i mniejsze uszkodzenia względne. Uchwyt zabiegowy można zbliżyć do obszaru zabiegowego, dzięki czemu plamka świetlna jest większa, a uszkodzenia względne mniejsze.

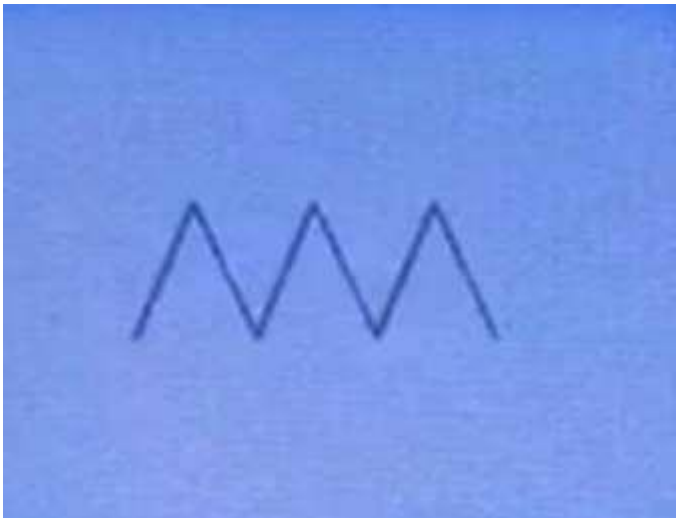

---

3. Funkcja trybu intymnego (Private Mode):


(1) Odmładzanie pochwy
(2) Ujędrnianie pochwy
(3) Leczenie nietrzymania moczu
(4) Zwężanie pochwy
(5) Upiększanie pochwy
(6) Pielęgnacja pochwy


Parametry zabiegu:

- Moc lasera: 19 W

- Czas trwania: 1,0 ms
- Liczba punktów: 10
- Odstęp między liniami: 1,0 mm
- Tryb skanowania: losowy
- Liczba skanów: 1
- Liczba linii skanowania: 5



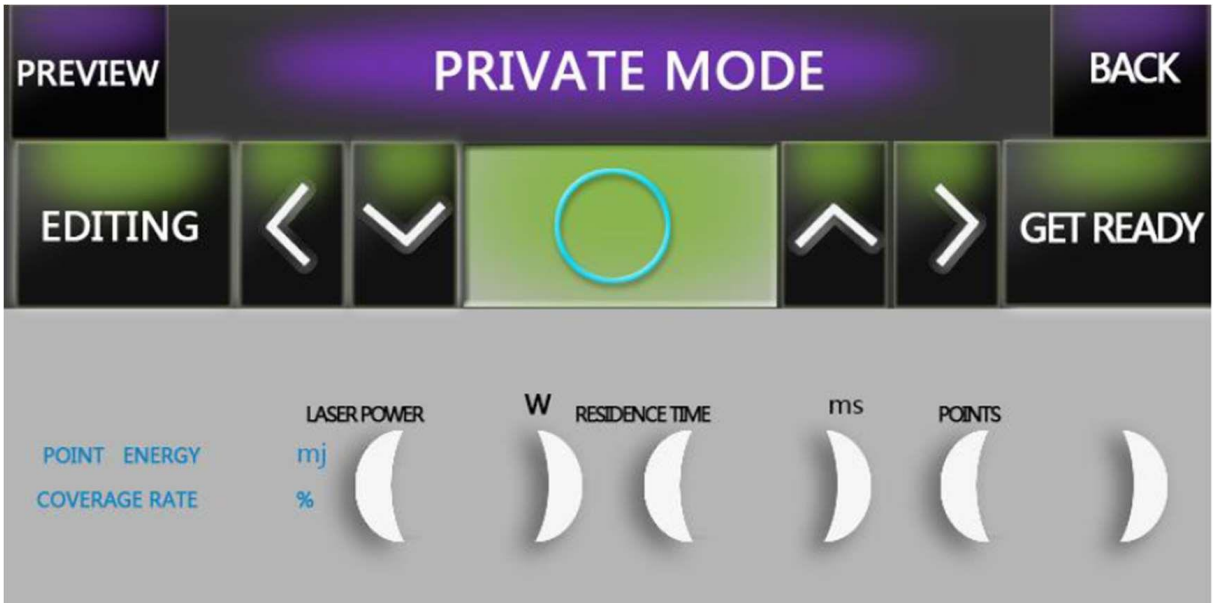

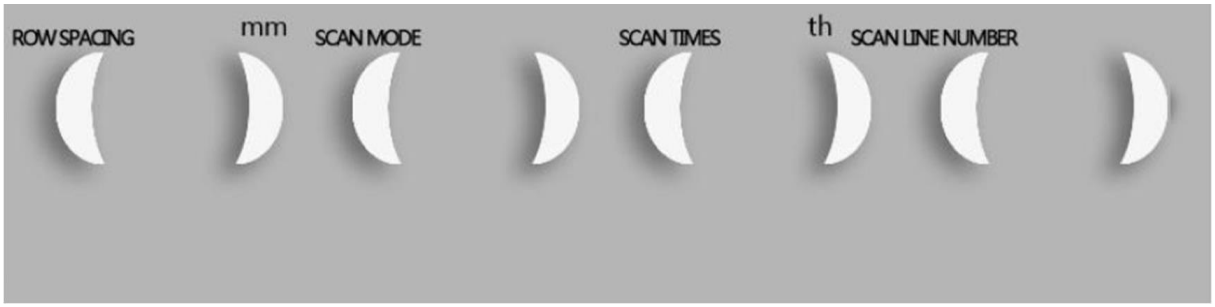




4. Funkcja trybu warg sromowych (Vulva Mode):

(1) Wybielanie warg sromowych
(2) Modelowanie warg sromowych

(3) Upiększanie warg sromowych
(4) Upiększanie otoczek sutkowych

Parametry zabiegu:

- Moc: 7 W
- Czas trwania: 1,0 ms
- Czas przerwy: 1,0 ms
- Odstęp między punktami: 1,5 mm
- Tryb skanowania: losowy
- Liczba skanów: 1

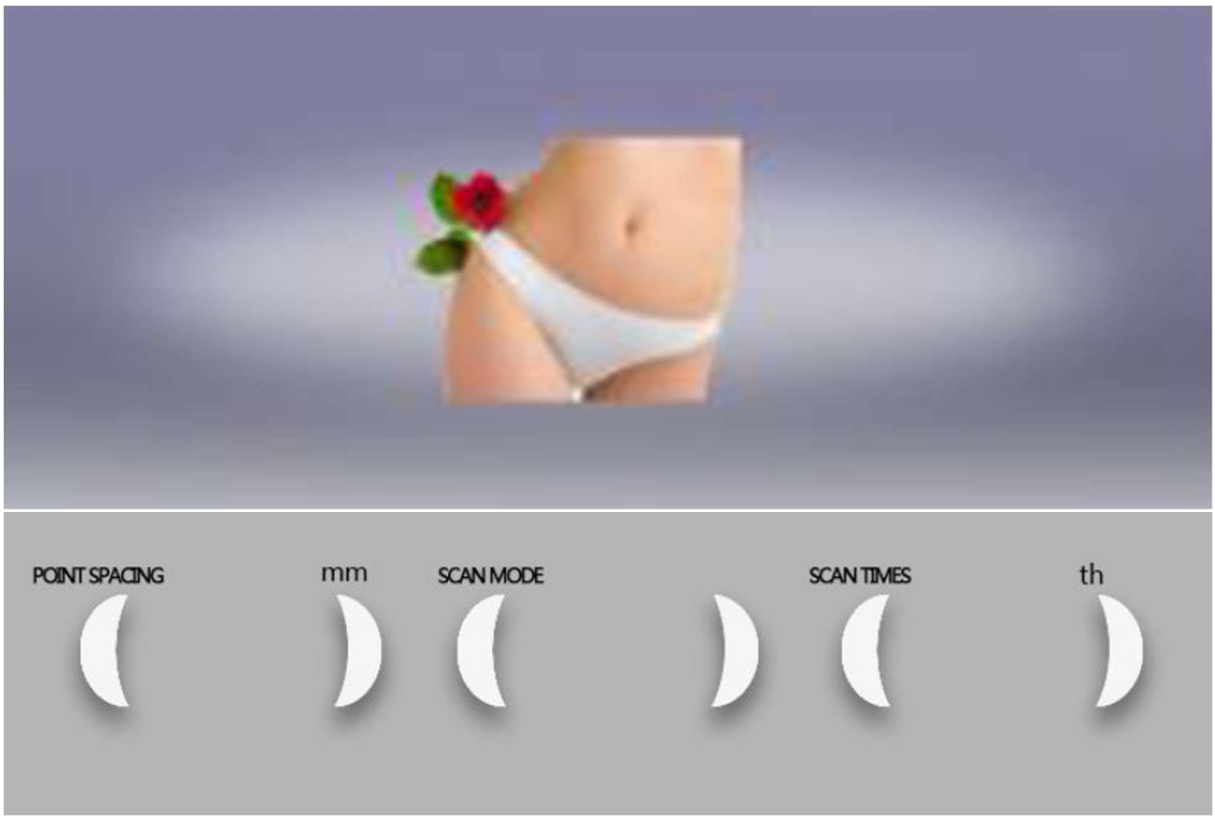


PREVIEW
KEEP
VULVAE MODE
BACK
EDITING
GET READY
POINT ENERGY
mj
COVERAGE RATE
%
POWER
W
RESIDENCE TIME
ms
INTERVAL TIME
ms

